


Участок дифференциальной откачки (North/South)

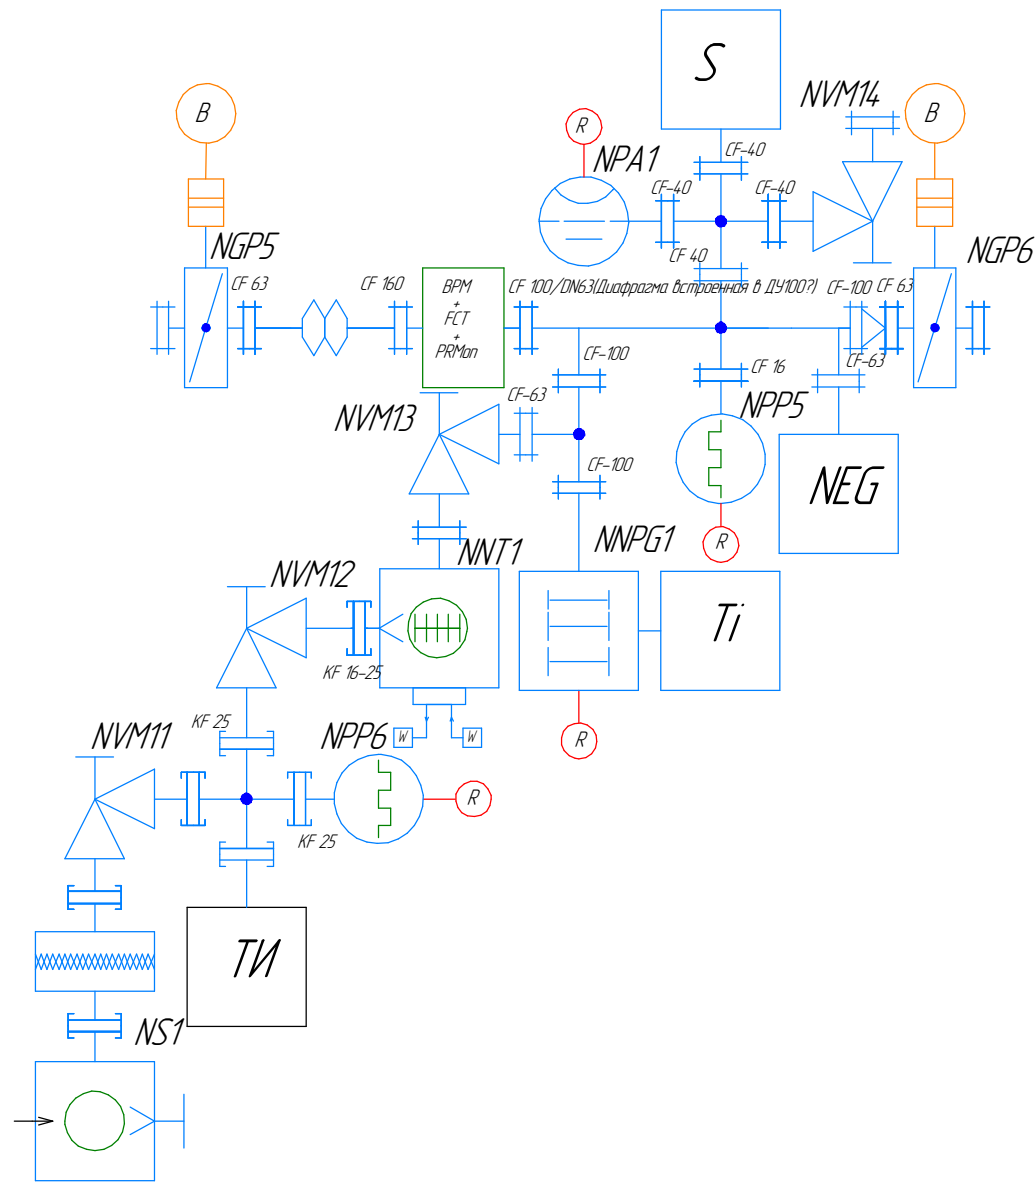

Обоз.	Наименование	Кол.	Примечание
NT1	Насос турбомолекулярный HiPace 300H	2	DN 100CF-F SH=68л/с
NPG	Насос ионно-геттерный с сублимационной панелью	2	Agilent Vac ion 150 DN 100CF-F; SH=150л/с
NEG	Насос с нераспыляемым геттером	2	DN 100 CF-F; SH=1000л/с
NS	Насос спиральный	2	DN 25 ISO-KF; SH=3л/с
NGP5, NGP6 SGP5, SGP6	Затвор электро-пневматический UHV цельнометаллический	4	DN 63 CF-F
NVM11, NVM12 SVM11, SVM12	Клапан ручной угловой	4	DN 25 ISO-KF
NVM14, SVM14	Клапан ручной угловой цельнометаллический	2	DN 40 CF-F
NVM13, SVM13	Клапан ручной угловой цельнометаллический	2	DN 63 CF-F
NPA1, SPA1	Датчик давления ионизационный с горячим катодом	2	DN 40 CF-F
NPP5, SPP5	Датчик давления терморезистивный, радиационно-стойкий	2	TPR 018; DN 16 CF-F
NPP6, SPP6	Датчик давления терморезистивный, радиационно-стойкий	2	TPR 018; DN 16 ISO-KF
IPC	Блок управления ионно-геттерного насоса	2	4UHV, 1 канал 200Вт
TSP	Блок распыления титановой сублимационной панели	2	

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А3